

GUIA RÁPIDO DE USABILIDADE


EQUIPAMENTOS DE VIDEOCIRURGIA

• MONITOR DE GRAU MÉDICO •




Liga/Desliga


• INSUFLADOR DE CO2 •

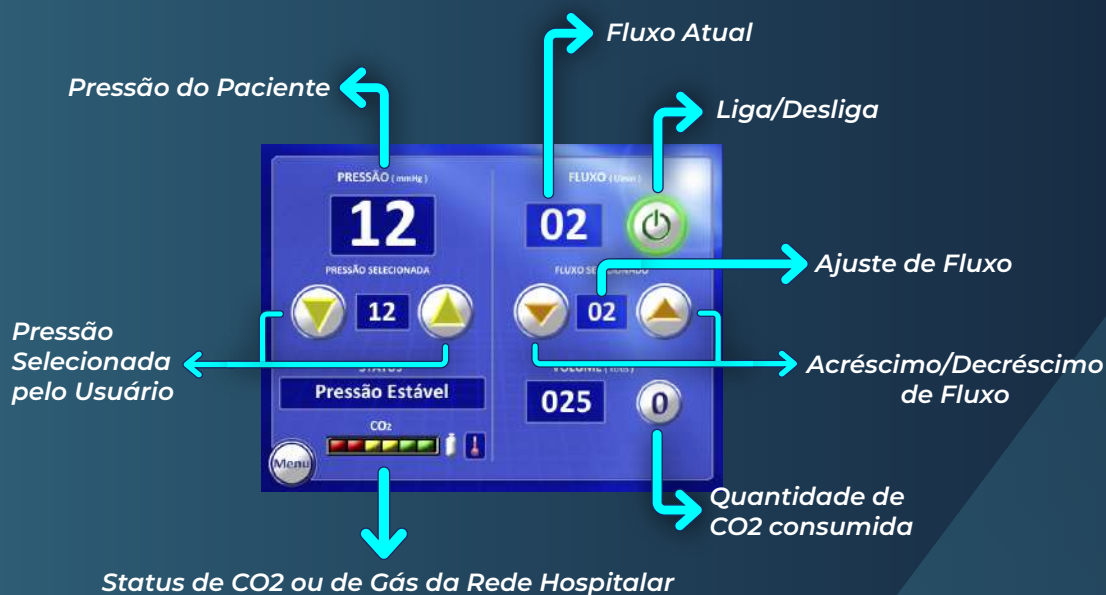

• MICROCÂMERA •

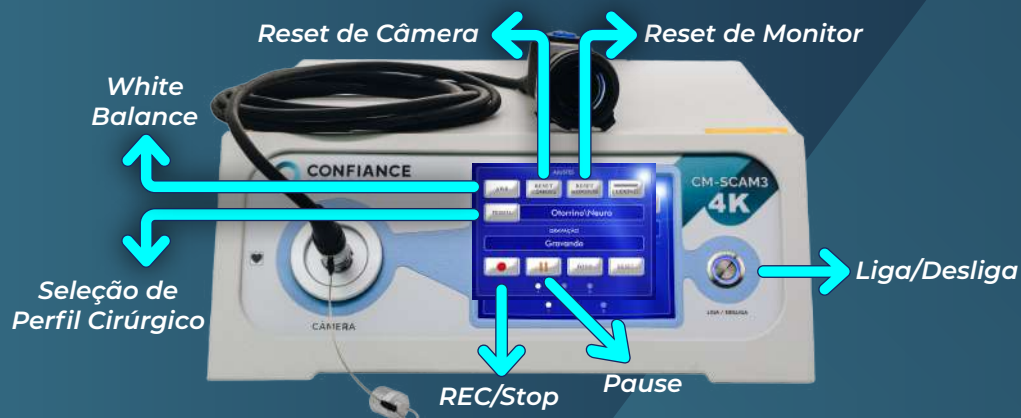



ATENÇÃO:
Para gravação direta da câmera,
o pen drive precisa estar
formatado em FAT32.

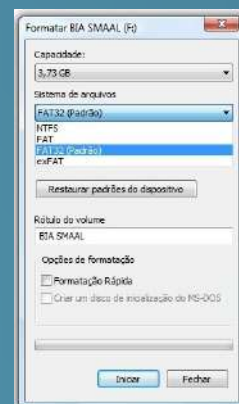

• FONTE DE LUZ •



• SISTEMA DE GRAVAÇÃO •

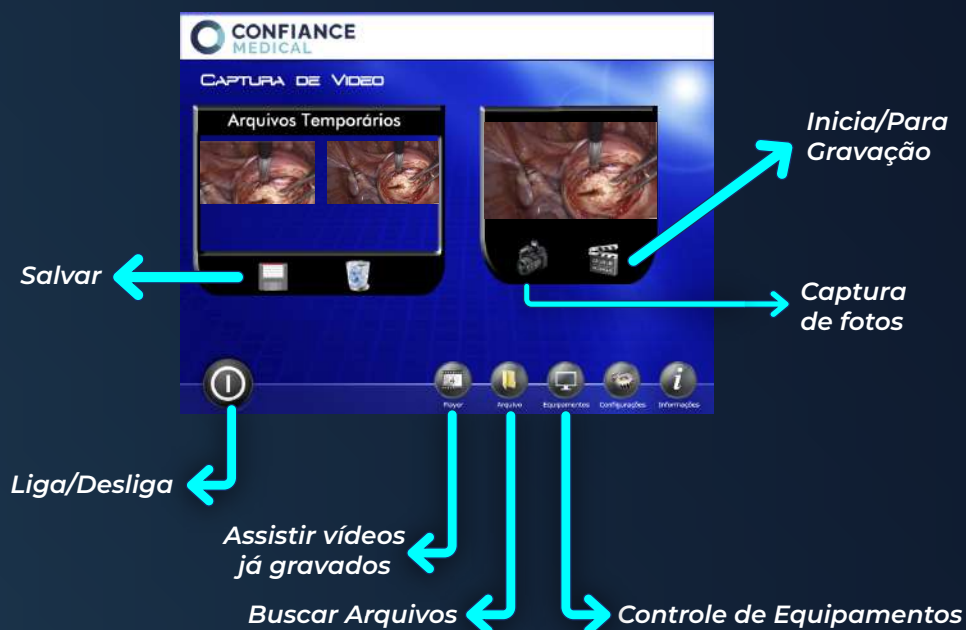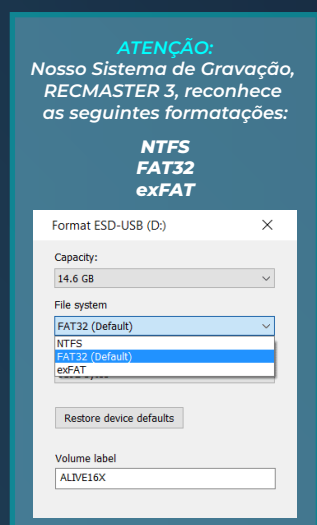

CONFIANCE
MEDICAL



ENTREGAR
+ **SEGURANÇA**



TER CIRURGIÕES
+ **SATISFEITOS**



LEVAR
+ **INOVAÇÃO**



ATINGIR
+ **PESSOAS**

www.confiancemedical.com.br

#PorUmMundoSemCicatriz